AVVISO DI SICUREZZA URGENTE - Getinge WD15 Claro

Problematica riscontrata Possibile perdita d'acqua	Data *19 LUGLIO 2018*	Rif. no. CCS219711
Prodotto interessato: Getinge WD15 Claro, Modello GE15	N. di serie interessati (vedasi ubicazione nella pagina seguente) Da WAA078527 a WAA079522 Da WAA082404 a WAA085431 e WAA085543	
Risoluzione Semplice lettera di notifica. Le comunicazioni successive si concentreranno sulla risoluzione del problema.		

Gentile cliente:

La presente lettera ha lo scopo di informarLa in merito a una possibile perdita d'acqua in alcuni termodisinfettori modello GE15. Se il problema dovesse verificarsi, il display della macchina emetterà un allarme sia acustico che visivo. La perdita potrebbe verificarsi nell'ultima parte del ciclo di pulizia e disinfezione, durante il funzionamento.

Se il problema non viene affrontato, potrebbe verificarsi una perdita di acqua fredda dall'alimentazione dell'acqua alla macchina. Se l'allarme viene ignorato, una quantità significativa di acqua potrebbe riversarsi sul pavimento rendendolo scivoloso e potenzialmente pericoloso per le persone, che potrebbero cadere, e per i beni, che potrebbero essere danneggiati dall'acqua.

Consigli sulle misure da intraprendere
Non azionare la macchina senza sorveglianza, soprattutto se non è possibile deviare l'acqua verso lo scarico. In caso di allarme agire immediatamente.
In caso di allarme, procedere come segue:

- disinserire l'interruttore generale
- chiudere le valvole di intercettazione delle condutture di alimentazione dell'acqua
- contattare l'assistenza tecnica

La presente Notifica di sicurezza contiene informazioni importanti sull'utilizzo sicuro e corretto dell'apparecchiatura

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE - Getinge WD15 Claro

Posizione del Numero di serie

Il Numero di serie del termodisinfettore è indicato sull'etichetta di marcatura della macchina.

Osservando GE15 dalla parte anteriore,
l'etichetta si trova sul lato destro.

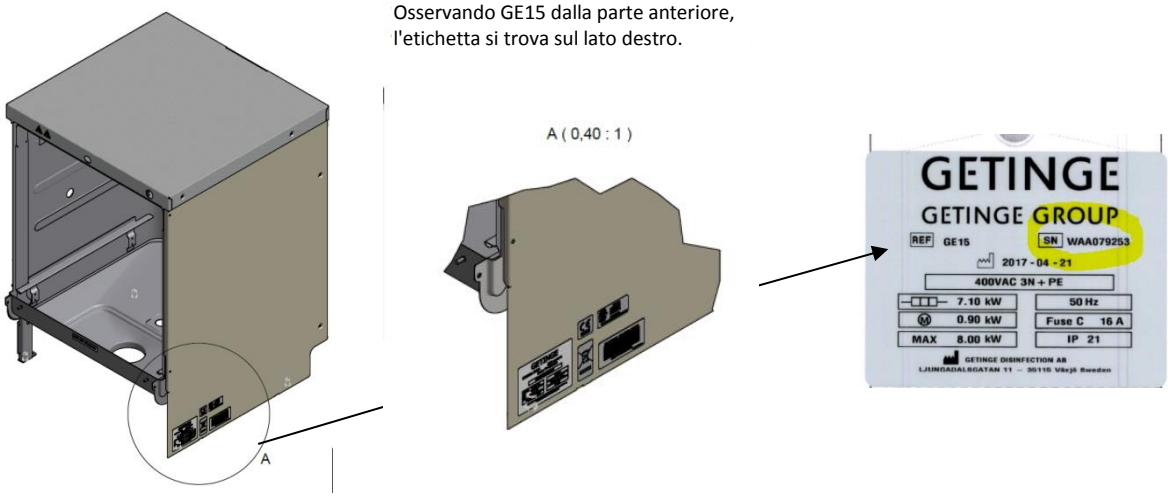

Trasmissione della presente notifica di sicurezza sul campo:
Assicurarsi che la presente notifica venga comunicata al personale responsabile del funzionamento della macchina. Attenersi alle presenti informazioni fino alla comunicazione di nuove informazioni sulla questione.

Ulteriori informazioni e assistenza
Ci scusiamo per qualunque inconveniente causato. Stiamo esaminando la questione con la massima attenzione e stiamo cercando di individuare la causa del problema per fornire una soluzione il prima possibile. La contatteremo non appena avremo individuato una soluzione. In caso di domande sulla macchina installata, contattare il rappresentante Getinge.

Cordialmente,

Chiara Pelini
Regulatory&Quality Manager
Getinge Italia S.p.A.

Data, timbro e firma del cliente per presa visione

_____